

采购肺功能检测仪、灭菌器真空泵维修项目废标公告

招标项目编号 (RHST-20260011)

一、中标人信息

【1】肺功能检测仪:

中标人: // ,中标价格: 0万元

【2】灭菌器真空泵:

中标人: // ,中标价格: 0万元

二、其他

1: 具体内容详见公告附件;

2: 公告发布媒介: 《内蒙古招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》;

三、监督部门

本项目监督部门为乌审旗人民医院。

四、联系人

招标人: 乌审旗人民医院

地址: 鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇

联系人: 曹璟

电话: 18747720234

邮件: //

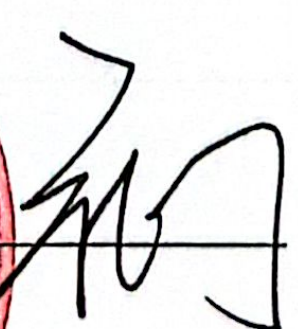
招标代理机构:内蒙古镕恒晟泰工程项目管理有限公司

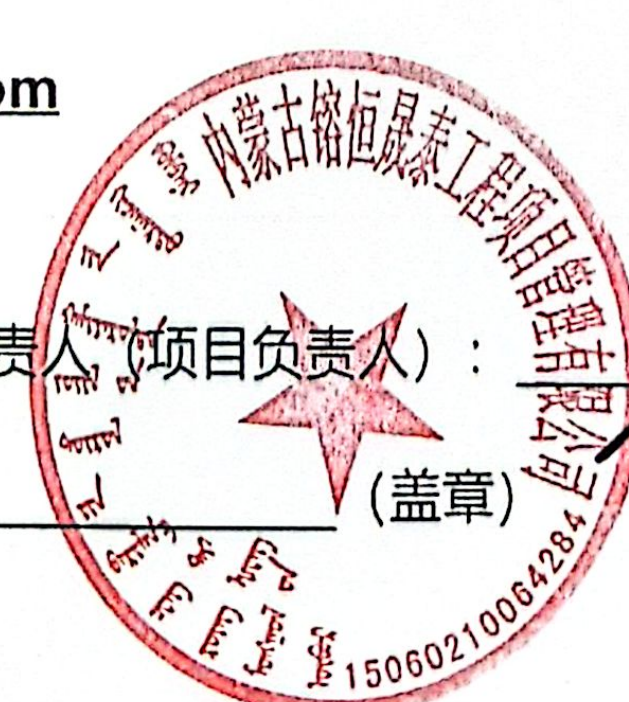
地址: 鄂尔多斯市东胜区铁西锦厦国际商务广场2号楼603室

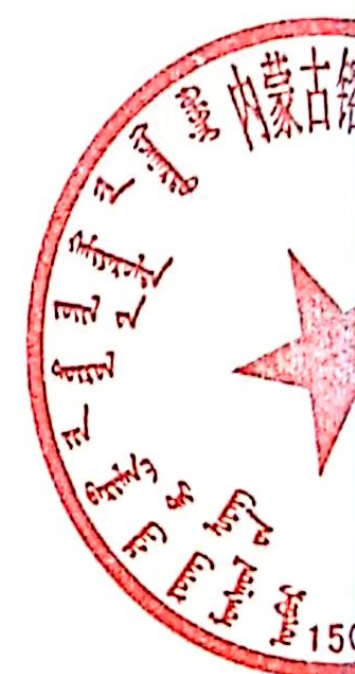
联系人: 张丁

电话: 18847183264

邮件: 470757224@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人):  (签名)

招标人或其代理机构:  (盖章)



附件

采购肺功能检测仪、灭菌器真空泵维修项目废标公告

一、项目编号：RHST-20260011

二、项目名称：采购肺功能检测仪、灭菌器真空泵维修项目

三、采购结果

废标理由：合同包 1(合同包一)、合同包 2(合同包二)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的

四、主要标的信息

无（废标）。

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：//。

六、代理服务收费标准及金额：

本项目代理费收费标准：//。

本项目代理费总金额：0 万元（人民币）

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其它补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：乌审旗人民医院

地址：鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇

联系方式：曹璟 18747720234

2. 采购代理机构信息

名称：内蒙古镕恒晟泰工程项目管理有限公司

地址：鄂尔多斯市东胜区铁西锦厦国际商务广场 2 号楼 6 层 603 室

联系方式：张丁 18847183264

3. 项目联系方式

项目联系人：张丁

电话：18847183264

